

## **Домоевая кислота ИФА**

*5191DOMO [9]05.23*

Конкурентный иммуноферментный анализ для количественного определения  
домоевой кислоты в образцах гребешков, мидий и устриц

Пожалуйста, обращайтесь по вопросам технической поддержки и дополнительной информации к официальным дистрибуторам на территории Вашей страны:

**Официальный дистрибутор  
в России:**  
**ООО "НеоТест"**  
ул. Растопчина, 1Г, г. Владимир  
+7 499 911 02 01  
[info@neo-test.ru](mailto:info@neo-test.ru)  
[www.neo-test.ru](http://www.neo-test.ru)

**Техническая поддержка**  
[support@neo-test.ru](mailto:support@neo-test.ru)  
+7 499 444 05 50



**Официальный дистрибутор  
в Беларуси:**  
**ОДО "КомПродСервис"**  
ул. Филимонова, 25Г, г. Минск  
+375 17 336 50 54  
[info@komprod.com](mailto:info@komprod.com)  
[www.komprod.com](http://www.komprod.com)


**Техническая поддержка**  
[support@komprod.com](mailto:support@komprod.com)  
+375 17 336 50 54



## КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Тест-набор для ИФА домоевой кислоты – это конкурентный иммуноферментный анализ для скрининга и количественного анализа домоевой кислоты в различных матрицах. Основой тест-набора являются кроличьи поликлональные антитела к домоевой кислоте. С помощью этого ИФА-набора возможно проведение 96 определений. Анализ проб и градуировочных растворов выполняется в параллелях, таким образом, с помощью одного набора может быть осуществлен анализ 40 проб. Тест-набор содержит все реагенты, включая готовые градуировочные растворы, необходимые для проведения анализа. Материалы и реагенты, необходимые для экстрагирования домоевой кислоты из пробы, не включены в тест-набор.

### 1. ВВЕДЕНИЕ

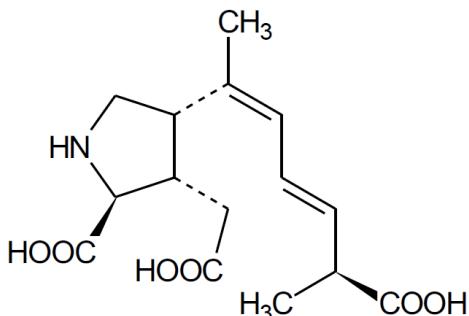

Химическая структура домоевой кислоты (DA)

Морские биотоксины, также называемые фитотоксинами или токсинами моллюсков, представляют собой природные соединения, вырабатываемые водорослями и фитопланктоном. В нормальных условиях эти соединения не вызывают никаких проблем. Однако фильтраторы, такие как моллюски, мидии, устрицы и ракообразные, могут потреблять большие количества этих водорослей, когда условия окружающей среды приводят к вредоносному цветению водорослей, также известному как «красные приливы». Высокие концентрации токсинов моллюсков затем накапливаются в организме этих животных, вызывая заболевания среди людей, которые их едят. Существует четыре синдрома, называемых отравлением моллюсками: паралитическое отравление моллюсками (PSP), нейротоксическое отравление моллюсками (NSP), диарейное отравление моллюсками (DSP) и амнестическое отравление моллюсками (ASP). Сообщается, что эти отравления вызывают различные симптомы, включая спазмы желудка, боли в животе, диарею, головные боли, потерю памяти, паралич и в некоторых случаях даже смерть.

PSP вызывается сакситоксином и его аналогами. DSP в первую очередь вызывается окадаиновой кислотой (OA) и некоторыми аналогами OA, тогда как ASP вызывается домоевой кислотой (DA).

DA – аминокислота, имеющая структуру глутаминовой кислоты и напоминающая кайновую кислоту. Впервые это было отмечено как проблема морских млекопитающих в 1998 году, когда многие калифорнийские морские львы погибли вдоль побережья Центральной Калифорнии. В 2003 году было исключительно большое количество случаев DA.

DA вырабатывается фитопланктоном *Pseudo-nitzschia*.

В Европейском Союзе Регламент (ЕС) № 853/2004 предусматривает, что живые двустворчатые моллюски не должны содержать DA в общем количестве (измеренном во всем теле или в любой съедобной части отдельно), превышающем предел в 20 мг DA на килограмм.

### 2. ПРИНЦИПЫ ИФА НИТРОФУРАНА АНД

Тест-набор для проведения ИФА включает 12 стрипов по 8 лунок, сенсибилизованных антителами к кроличьим иммуноглобулинам. Антитела (кроличьи поликлональные антитела к домоевой кислоте), домоевая кислота, маркированная пероксидазой хрена (ферментно маркированный коньюгат), градуировочные растворы либо растворы проб вносятся в лунки планшета. Во время инкубации кроличьи антитела к домоевой кислоте связываются с иммобилизованными антителами захвата в лунках планшета, одновременно с этим домоевая кислота, присутствующая в

пробе либо градуировочном растворе, конкурируя с ферментно маркированным конъюгатом, связывается с антителами к домоевой кислоте (конкурентный ИФА). После 30-минутной инкубации несвязанные реагенты удаляются на стадии промывки

Количество связанной ферментно маркированной домоевой кислоты визуализируется внесением смеси субстрат/хромоген. Бесцветный хромоген окрашивает фермент (пероксидазу хрена) в голубой цвет. Большее количество домоевой кислоты в пробе или градуировочном растворе вызывает более слабое окрашивание. Реакция окрашивания останавливается внесением серной кислоты. В кислой среде голубой цвет изменяется на желтый. Интенсивность окрашивания измеряется фотометрически при длине волны 450 нм, она обратно пропорциональна концентрации домоевой кислоты в пробе.

### **3. СПЕЦИФИЧНОСТЬ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ**

Для данного набора ИФА для определения домовой кислотой используют специфическое антитело, полученное путем иммунизации кроликов конъюгатом с белком домовой кислоты.

Перекрестная реактивность:

Домоевая кислота	100%
Окадаиковая кислота	< 0,10%
DTX-1 и DTX-2	< 0,10%
Сакситоксин	< 0,10%
Неосакситоксин	< 0,10%
Гониаутоксины GTX 2/3, 1/4	< 0,10%
B1 и B2	< 0,10%
C 1/2	< 0,10%

Перекрестную реактивность определяют в буферной системе. Полученные значения могут отличаться от значений, полученный для реальных образцов из-за влияния эффектов матрицы.

Тест не позволяет отличить аналиты от перекрестно-реактивных веществ.

Предел обнаружения (LOD) определяется в оптимальных условиях. Критерии CUT-OFF требуют критического рассмотрения.

Матрица	LOD (ppb)
Гребешки	23
Мидии	21
Устрицы	23

Если установлено, что образец не соответствует требованиям, результаты должны быть проверены путем повторного анализа образца с использованием подтверждающего метода.

### **4. УСЛОВИЯ ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЕ**

- Набор реагентов должен храниться при температуре от +2°C до +8°C в темном месте. Не замораживать.

- Неиспользованные лунки планшета должны храниться закрытыми в оригинальной упаковке.
- После истечения срока годности невозможно гарантировать приемлемое качество.
- Восстанавливать или разводить компоненты набора необходимо непосредственно перед использованием, но после того, как компоненты согрелись до комнатной температуры.
- Необходимо избегать любого прямого воздействия света на раствор субстрата/хромогена.
- Окрашивание хромогена является признаком порчи реагентов. Реагент должен быть утилизирован.
  - Стоп-реагент содержит серную кислоту. Следует избегать контакта с кожей.
  - Разведение реагентов либо их замена по истечении срока годности тест-набора может повлиять на чувствительность тест-набора.
  - Оптическая плотность нулевого градуировочного раствора менее 0,6 опт. единиц может означать порчу реагентов


- Избегайте попадания пузырьков воздуха в лунки при проведении анализа. Перед считыванием результатов на фотометре убедитесь в отсутствии пузырьков в лунках, т.к. это может повлиять на результат считывания оптической плотности.

- Домоевая кислота распадается при воздействии света или тепла.

## 5. СОСТАВ НАБОРА

### Инструкция

Один запечатанный микротитровальный планшет (12 стрипов по 8 лунок),  
Позиции реагентов в наборе. Для приготовления реагентов смотрите раздел 8.

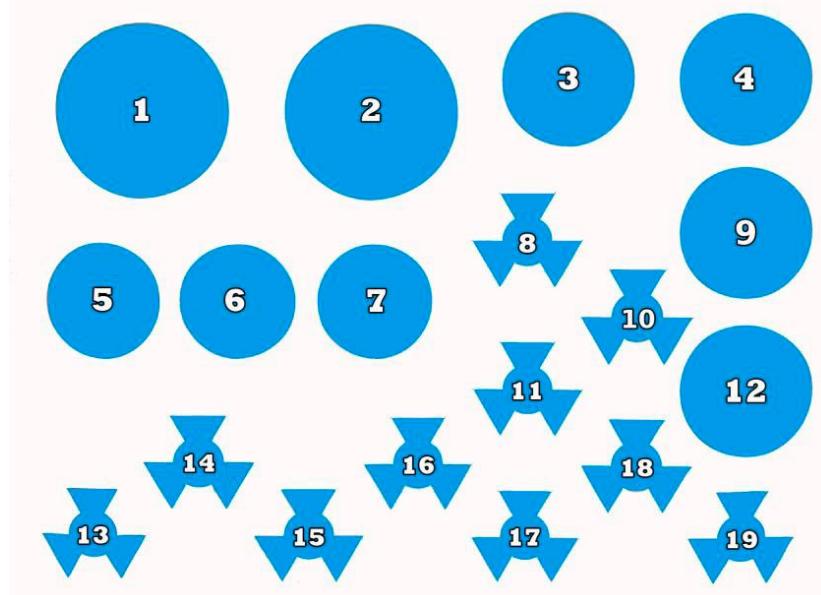

1. Буфер для разведения (30 мл, 10x концентрат)
2. Промывочный буфер (10 мл, 20x концентрат)
3. Раствор субстрата (12 мл, готов к использованию)
4. Стоп-раствор (15 мл, готов к использованию)
5. не используется
6. Антитела (лиофилизат, желтая крышка)
7. не используется
8. Коньюгат (100x концентрат)
9. не используется
10. не используется
11. не используется
12. не используется
13. Нулевой стандарт, раствор (2 мл, готов к использованию)
14. Стандартный раствор 1 (1 мл, готов к использованию) 0.05 нг/мл
15. Стандартный раствор 2 (1 мл, готов к использованию) 0.1 нг/мл
16. Стандартный раствор 3 (1 мл, готов к использованию) 0.2 нг/мл
17. Стандартный раствор 4 (1 мл, готов к использованию) 0.5 нг/мл
18. Стандартный раствор 5 (1 мл, готов к использованию) 1.0 нг/мл
19. Стандартный раствор 6 (1 мл, готов к использованию) 2.0 нг/мл

## 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

- Весы и сосуды для взвешивания
- Перчатки
- Вытяжной шкаф
- Гомогенизатор
- Вортекс, миксер
- Центрифуга (4000 x g)

- Автоматический микротитровальный планшет или 8-канальная микропипетка 100–300 мкл.
- Шейкер для микротитровальных планшетов
- Считыватель микротитровальных планшетов с фильтром 450 нм
- Микропипетки 0,5 – 10 мкл
- Микропипетки, 100 – 1000 мкл
- Мультипипетка с комбинированными наконечниками емкостью 2,5 мл.
- Метанол
- Фильтр 0,45 мкм
- Дистиллированная вода

## **7. МЕРЫ ПРЕДСТОРОЖНОСТИ**

- Этот набор может содержать опасные вещества. Примечания об мерах предосторожности см. в соответствующих паспортах безопасности (SDS).

- Избегайте попадания всех биологических материалов на кожу и слизистые оболочки.
- Не пипетируйте ртом.
- Не ешьте, не пейте, не курите, не храните и не готовьте пищу, а также не наносите косметику в отведенной для этого рабочей зоне.
- Не используйте компоненты с истекшим сроком годности и не используйте компоненты из разных партий.
- Каждая лунка в конечном итоге используется как оптическая кювета. Поэтому не прикасайтесь к нижней поверхности колодцев, чтобы не допустить повреждений и загрязнения.
- Перед применением все компоненты должны быть полностью растворены. Особое внимание обратите на субстрат и промывочный буфер, которые кристаллизуются при +4°C.
- Оптимальные результаты будут получены при строгом соблюдении протокола промывки. Для обеспечения хорошей точности и аккуратности на протяжении всей процедуры необходимо тщательное пипетирование и промывание.

## **8. ПРОБОПОДГОТОВКА**

### Ткань моллюсков

- К 1 г гомогенизированной ткани моллюсков добавьте 1 мл воды.
- Перемешайте в течение 1 минуты.
- Добавьте 2 мл метанола 100%.
- Перемешайте в течение 1 минуты.
- Центрифугируйте при 2000 x g в течение 10 минут.
- Отберите прозрачную надосадочную жидкость и профильтруйте через фильтр 0,45.
- Разбавьте образцы в буфере для разведения (1:100). (Внесите 10 мкл образца в пипетку и добавьте 990 мкл буфера для разведения).
- Тщательно перемешайте.
- Используйте 50 мкл полученного раствора на лунку.

## **9. ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ**

Перед использованием тест-системы доведите температуру всех реагентов до комнатной (20 - 25°C). Неиспользуемые реагенты должны быть немедленно помещены в оригинальную упаковку на хранение при +2°C–+8°C. Для длительного хранения см. раздел 4 (Условия обращения и хранения).

Тест-набор содержит количество реагентов, достаточное для проведения не менее 96 анализов (включая градуировку). Анализ каждого градуировочного раствора и пробы выполняется в повторностях.

### Микротитровальный планшет

Не требуемые стрипы должны храниться с осушителем в плотно закрытом оригинальном пакете при температуре 2 - 8 °C.

### Буфер для промывки

Буфер для промывки поставляется в концентрации 20x. Раствор должен готовиться непосредственно перед использованием. Для каждого стрипа необходимо 40 мл разведенного буфера для промывки (2 мл концентрированного буфера + 38 мл дистиллированной воды).

### Раствор субстрата

Раствор субстрата (готовый к применению) осаждается при температуре +4°C. Бутылочку с ним необходимо довести до комнатной температуры (в темноте) и перемешать содержимое перед внесением в лунки.

### Буфер для разведения (концентрации 10x)

Буфер для разведения поставляется в концентрации 10x. Перед разведением (10 мл концентрата буфера + 90 мл дистиллированной воды) буфер необходимо довести до комнатной температуры и тщательно перемешать. Раствор буфера может кристаллизоваться при температуре +4°C, поэтому его необходимо тщательно перемешать перед разведением дистиллированной водой. Разведенный буфер может храниться в холодильнике (+2°C - +8°C) до окончания срока годности, указанного на этикетке.

### Коньюгат

Ферментно маркованный коньюгат домоевой кислоты поставляется в концентрированном виде. Центрифугированием (в течение 1 минуты при 1000g) обеспечивают стекание концентрата на дно бутылочки. Концентрат разводят буфером для разведения (напр. 5 мкл концентрата коньюгата + 495 мкл буфера для разведения). На 2 стрипа по 8 лунок требуется 400 мкл раствора коньюгата. Не требуемый концентрат коньюгата должен сразу же быть помещен в темное холодное место (+2°C - +8°C).

### Антитела к домоевой кислоте

Антитела к домоевой кислоте поставляются в лиофилизированном виде. Восстановление антител осуществляется добавлением 4 мл буфера для разведения и тщательным перемешиванием.

Восстановленные антитела сразу же быть помещены в темное холодное место (+2°C - +8°C).

## **10. ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА**

### Протокол промывки

При ИФА между каждым этапом иммунологической инкубации должны удаляться несвязанные компоненты. Это достигается посредством соответствующей процедуры промывки. Очевидно, что каждая процедура промывания должна проводиться с большой тщательностью для гарантирования хороших результатов повторяемости и воспроизводимости.

В принципе, промывка вручную или с помощью автоматического вошера может осуществляться следующим образом:

### Промывка вручную

1. Жидкость из лунок выливают путем резкого переворачивания планшета
2. Все лунки заполняют буфером для промывания до края лунки (300 мкл)
3. Этот процесс промывки (этапы 1 и 2) повторяют трижды.
4. Жидкость из лунок выливают путем резкого переворачивания планшета
5. После последнего промывания планшет переворачивают и удаляют остатки жидкости путем энергичного троекратного постукивания рамки с лунками по столу, накрытому листом сухой фильтровальной бумаги.
6. Не допускайте высыхания лунок перед внесением следующего реагента.

### Промывание с помощью автоматического вошера

При использовании автоматического вошера проверьте, чтобы из всех лунок жидкость удалялась полностью, чтобы раствор для промывания тщательно распределялся, заполняя до края

каждую лунку во время каждого цикла промывания. Вошер должен быть запрограммирован на выполнение трех циклов промывки.

#### Протокол анализа

1. Подготовьте пробы в соответствии с разделом 7 (Подготовка проб) и подготовьте реагенты в соответствии с разделом 8 (Приготовление реагентов). Микротитровальный планшет готов к использованию.
2. Вносят 100 мкл нулевого градуировочного раствора в двух повторностях (лунки A1, A2).  
Вносят 50 мкл нулевого градуировочного раствора в двух повторностях (лунки B1, B2).  
Вносят 50 мкл каждого градуировочного раствора в двух повторностях (лунки от C1,2 до H1,2, т.е. 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1 и 2 нг/мл).  
Вносят по 50 мкл каждой пробы в двух повторностях (40 проб, 80 лунок).
3. Вносят по 25 мкл конъюгата во все лунки за исключением A1 и A2.
4. Вносят по 25 мкл раствора антител во все лунки за исключением A1 и A2.
5. Планшет запечатывают и аккуратными круговыми движениями в течение 1 мин перемешивают его содержимое.
6. Планшет инкубируют в течение 30 минут в темноте при комнатной температуре (20°C – 25°C).
7. Удаляют раствор из микротитровального планшета и промывают 3 раза буфером для промывания.
8. Вносят по 100 мкл раствора субстрата во все лунки. Тщательно перемешивают и инкубируют планшет в течение 15 минут при комнатной температуре (20°C – 25°C).
9. Вносят по 100 мкл стоп-реагента во все лунки.
10. Сразу же измеряют оптическую плотность при 450 нм.

## **11. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ**


Вычтите среднее значение оптической плотности (O.D.) для лунок A1 и A2 из отдельных значений O.D. для лунок, содержащих градуировочные растворы и пробы.

Значения O.D. для шести градуировочных растворов и проб (среднее значение двух повторностей) делят на среднее значение O.D. нулевого градуировочного раствора (лунки B1 и B2) и умножают на 100. Таким образом, нулевой градуировочный раствор принимается за 100% (максимальная оптическая плотность) и другие значения O.D. приводятся в процентах от максимальной оптической плотности.

$$\frac{\text{ОП стандарта (или образца)}}{\text{ОП стандарта } 0 \text{ нг/мл}} \times 100\% = \% \text{ от максимальной оптической плотности}$$

#### Градуировочная кривая:

Значения (% от максимальной оптической плотности), вычисленные для градуировочных растворов, наносятся на график (по оси Y) напротив эквивалентной концентрации домоевой кислоты (нг/мл) по логарифмической оси X.

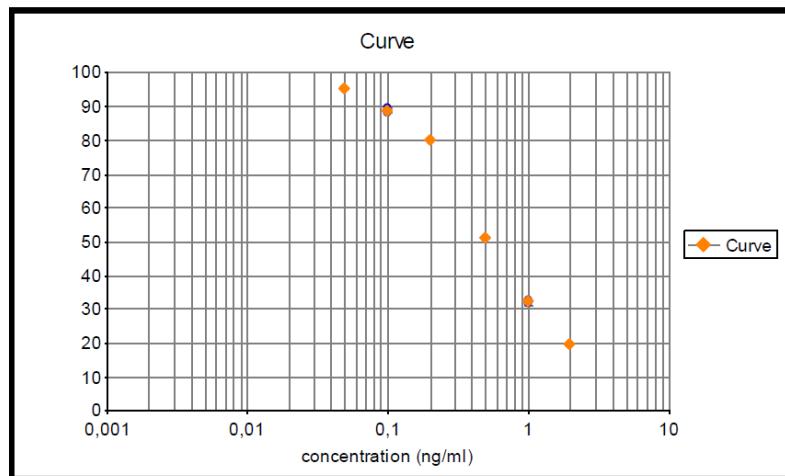**Пример градуировочной кривой**

Количество домоевой кислоты в пробе выражается как эквивалент домоевой кислоты. Эквивалент домоевой кислоты в пробе (нг/мл), соответствующий % от максимальной оптической плотности каждого экстракта, может быть получен по градуировочной кривой.

Значение концентрации домоевой кислоты, полученное по градуировочной кривой, должно быть умножено на 400 для получения значения концентрации домоевой кислоты в пробе.

## 12. ЛИТЕРАТУРА

M. Dubois, L. Demoulin, C. Charlier, G. Singh, S.B. Godefroy, K. Campbell, C.T. Elliott, and Ph. Delahaut (2010). Development of ELISA's for detecting domoic acid, okadaic acid, and saxitoxin and their applicability for the detection of marine toxins in samples collected in Belgium. Food Additives Contam. 27(6): 859-868.

European Commission 2004. Commission regulation 853/2004/EC of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin. Off. J. Eur. Comm. L226: 22-82.

## 13. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Для заказа тест-системы используйте артикул 5191DOMO.

## 14. ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Изменения по тексту и дополнение п. 3.